COLPOSCOPE À LED GIMA

• 29600 COLPY - COLPOSCOPE À LED GIMA
Colposcope à LED facile à utiliser monté sur un socle à 5 roulettes (Ø 41 cm).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COLPOSCOPE
Grossissement: 8,2X avec oculaires standard 10X
Champ: 35 mm
Système optique: stéréo avec réglage interpupillaire et tête optique à 45°
Éclairage: ampoule LED
Distance fonctionnelle: 28 cm
Distance interpupillaire: 48-77 mm
Filtre vert
Tension de fonctionnement: 100-240V, 50/60 Hz
Normes: CLASSE I Type B - CEI 601-1 CE 93/42/CEE.
Fabriqué en Italie

• 29601 CONNECTEUR CAMÉRA pour 29602
Pour connecter une caméra à un colposcope GIMA avec une «monture en C» classique.
• 29602 CAMÉRA MC1 PAL - pour Colpy
Monter la caméra sur un oculaire et connecter le colposcope au moniteur. Nécessite 29601.
• 29603 CAMÉRA DIGITALE DL1 - USB 2.0 - pour Colpy
Monté sur un oculaire, permet d'afficher l'image sur l'écran via connexion USB et devient un videocolposcope à haute défintion.

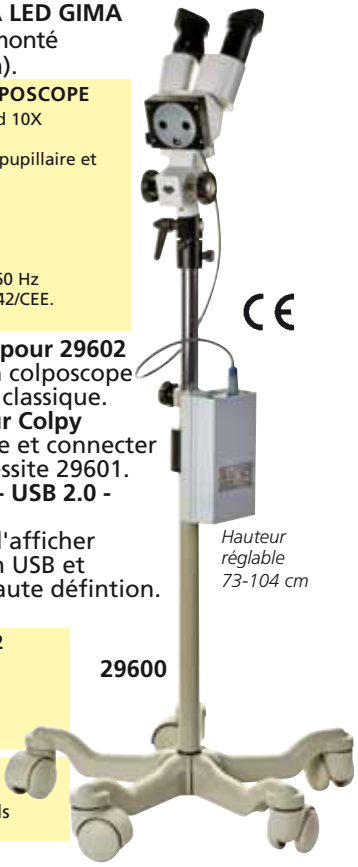

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - 29602
Capteur caméra: 1/3 CCD
Résolution: 480 lignes
Dimensions tête: 38 x 40 x 70 mm
Alimentation: 230 V - 50/60 Hz
Sortie vidéo composite RCA, câble 3 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - 29603
Capteur CMOS /3"
Résolution max image 1280 x 1024 pixels
Résolution max film 440 x 480 pixels

COLPOSCOPE À LED ALLTION

• 29612 COLPOSCOPE À LED ALLTION - 9X
• 29613 COLPOSCOPE À LED ALLTION 3,75x, 7x, 15x - > 28 000 LUX
Colposcope de qualité supérieure offrant d'excellentes optiques et une lumière blanche froide et durable. Compact, léger et facile à utiliser, il offre une qualité haut de gamme à un prix très compétitif. Sa rotule universelle spéciale en Téflon®, facilite le préréglage de la mise au point par un mouvement à 360°. Livré monté et prêt à l'emploi.

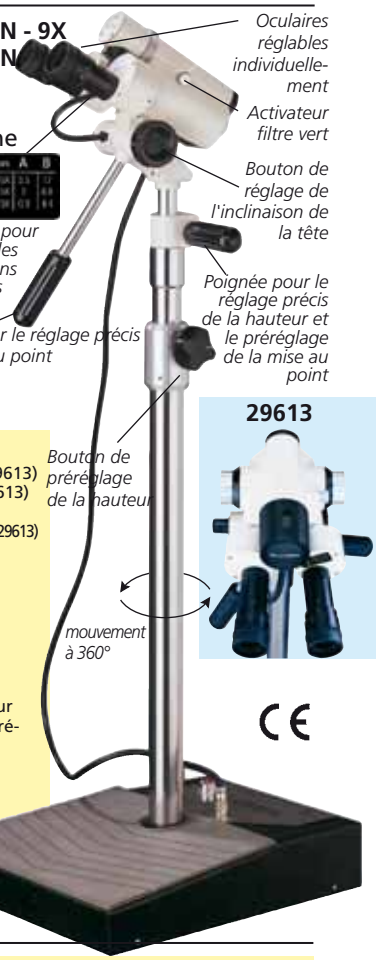
Oculaires réglables individuelle-ment
Activateur filtre vert
Bouton de réglage de l'inclinaison de la tête
Poignée pour le réglage précis de la hauteur et le préréglage de la mise au point
Poignée pour le réglage précis de la mise au point
Bouton de préréglage de la hauteur
mouvement à 360°
Socle à roulettes pour faciliter le mouvement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Grossissement 9X (29612) ou 3,75X, 7X, 15X (29613)
Longueur de focale: 316 (29612) ou 300 mm (29613)
Champ de vision: Ø 22 mm ou 30,93/15,50/7,64
Profondeur de champ: >4 mm (29612) ou 18/4/2 mm (29613)
Intensité lumineuse: >10 000 lux (29612) ou >28 000 lux (29613),
Oculaires réglables interchangeables 12,5X
Éclairage: LED 5,9V / 5W longue durée
Optiques de qualité supérieure avec oculaires réglables individuellement
Rhéostat intégré pour réglage de la lumière
Ampoule à DEL facile à remplacer
Filtre vert intégré sélectionnable par l'utilisateur
2 poignées de réglage de la mise au point (préré-glage et réglage précis)
2 poignées de réglage de la hauteur (préréglage et réglage précis)(838-1194 mm)
Commande sans heurt
Alimentation: 110V / 220V

29613

VIDÉO COLPOSCOPE NUMÉRIQUE À LED

• 29620 VIDÉO COLPOSCOPE À LED COLPRO
Ce vidéo colposcope est connu pour sa robustesse, sa souplesse, sa précision et sa facilité d'utilisation. Il incorpore la dernière technologie de traitement numérique du signal pour offrir des images haute résolution pour un diagnostic colposcopique et un traitement efficaces.
Large gamme de mise au point automatique: Se concentre automatiquement sur les objets jusqu'à 30 cm malgré d'éventuels mouvements du patient pendant la procédure.
Filtre vert électronique (5 niveaux), variation de l'intensité lumineuse et contraste de la couleur (5 niveaux).
Zoom continu: Zoom 1-45X permet d'examiner le col de l'utérus au grossissement souhaité.
E-flip et image miroir: Fonctions puissantes qui assurent une meilleure attention sur les détails minutieux.
Lumière très brillante sans ombre MCD: À une couleur de température 6 000°K, reproduit la couleur naturelle des tissus et vaisseaux.
1 200 000 pixels: Fournit une image très claire et une excellente qualité d'image pour sa classe.
Grossissement et affichage en temps réel: Affichage en temps réel du grossissement et minuterie test d'acide acétique qui aide à voir la meilleure image au grossissement voulu.
2 sorties vidéo: La sortie peut être affichée simultanément sur 2 différents moniteurs/ordinateurs. Connecteur universel: pour n'importe quel moniteur ayant une entrée vidéo Y/C ou BNC.
• 72708 MONITEUR MÉDICAL LMD LCD SONY - 15" - support compris

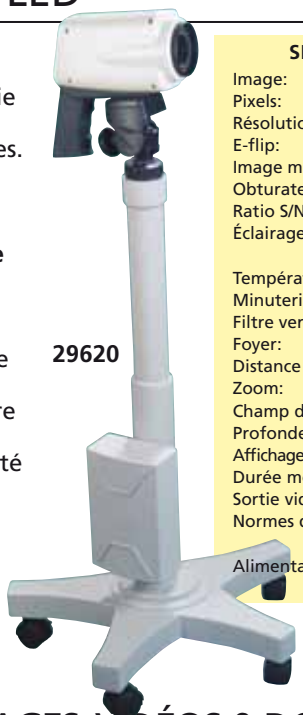

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Image:	Sony couleur CCD
Pixels:	1 200 000
Résolution:	lignes TV 825
E-flip:	oui
Image miroir:	oui
Obturateur électronique:	automatique
Ratio S/N:	>48db
Éclairage:	lumière LED très brillante sans ombre MCD
Température de couleur:	7 000°K
Minuterie test:	oui
Filtre vert électronique:	oui (5 étapes)
Foyer:	automatique ou manuel
Distance focale:	20-30 cm
Zoom:	1-45X
Champ de vision:	Ø 170 mm - 10 mm
Profondeur du champ:	Ø 200 mm - 5 mm
Affichage du grossissement:	oui
Durée moyenne de la lampe à LED:	20 000 heures
Sortie vidéo:	SD: 1x y/c, 1xBNC composite
Normes de sécurité:	conforme à IEC 60601 incluant EMC
Alimentation:	100-240VCA, 50/60Hz Fabriqué en Australie

CE 1293 **Testé EMI/EMC**

COLPOSCOPIE - LOGICIEL DE GESTION D'IMAGES, VIDÉOS & DONNÉES DES PATIENTS

• 29621 LOGICIEL DE COLPOSCOPIE POUR COLPRO ET AC-2311
Un puissant outil IT dans les mains de nos gynécologistes occupés pour gérer les vidéos, images, données cliniques et les détails concernant les patients, mais aussi pour stocker, éditer, graver sur CD ou DVD, imprimer des rapports détaillés et utiliser les données graphiques pour des présentations. Logiciel multilingue (FR, GB, IT, DE, ES, PT). Commande à pédale pour la capture et l'enregistrement d'images.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (64-bit) / XP / Vista
Facile à installer et entretenir. Un mot de passe protège l'identifiant pour une sécurisation des données. Grande facilité d'enregistrement de vidéo en temps réel et de capture d'images de haute qualité simultanément en un seul clic. Différents types de coupure de vidéo de colposcopie, films, images de référence et à but éducatif ont été intégrés au logiciel. Impression de rapports avec des détails pertinents peuvent être préparés pour le suivi futur du patient. Mode de ***comparaison*** *avec des images existantes.* ***Examen médico-légal*** *et d'abus sexuels. Approche de LEEP/LLETZ pour le traitement des dysplasies de haut degré. Rapport de* ***cryochirurgie****. Représentation statistique graphique des données. Rapport de diagnostic multi-format avec 1-2-3-4 images. Graphique HAMMOND (graphique de biopsie). Mise en évidence et marquage.*

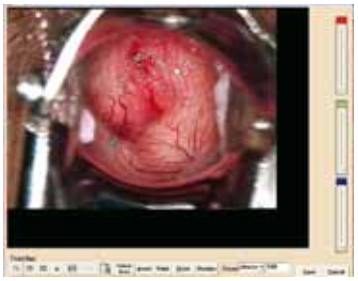

SONOST 3000 - OSTÉODENSITOMÈTRE À ULTRASON

• 33996 SONOST - 3000 avec logiciel Ostéodensitomètre à ultrason (sans eau)
Solution portative économique pour évaluer le risque de fracture ostéoporotique. Sa grande précision permet un premier diagnostic de l'ostéoporose à travers le suivi des modifications osseuses. Il fournit rapidement des informations utiles et facilement exploitables sur la qualité osseuse et le risque de fracture.
Peut être connecté à un clavier, un moniteur ou une imprimante externe pour imprimer au format A4.
Caractéristiques principales:
- extrême précision - système autonome et sans eau
- mesure rapide (15 s seulement)
- positionnement automatique de la sonde
- patch de couplage permanent
- mémoire de plus de 10 000 enregistrements

• 33250 PAPIER THERMIQUE 57 mm x 25 m (boîte de 5 rouleaux)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Site de mesure:	Calcanéum
Durée du balayage:	15 secondes
Mesure:	Estimation de la densité minérale (DMO) et de la qualité osseuses (BQI) du talon Obtenues par mesure de l'atténuation des ultrasons (BUA) et de la vitesse de propagation du faisceau ultrasonore (SOS)
Indices estimés:	SOS (C.V. en %) BUA (C.V. en %) BQI (C.V. en %)
In Vivo:	0,2 1,5 1,5
Capteur:	25 mm - 100 mm
Plage de séparation:	Réglage automatique
Capacité de stockage:	Informations sur 10 000 patients
Méthode de couplage:	Gel de couplage (pas d'eau)
Écran:	LCD TFT 6,4 pouces (65 536 couleurs)
Interface utilisateur:	Écran tactile Connecteur USB pour raccordement à la souris ou au clavier
Imprimante:	Imprimante thermique
Tension de fonctionnement:	CA 100 V~240 V - 50/60 Hz - 130 W
Dimensions:	30 x 62 x 39 cm
Poids:	12 kg

VIDÉOCOLPOSCOPE À LED AC-2311 AVEC CAMÉRA

• 29624 VIDÉOCOLPOSCOPE À LED AC-2311 AVEC CAMÉRA
- son optique de qualité supérieure garantit:
1 - résolution élevée
2 - reproduction fidèle des images en 3 dimensions
3 - grande profondeur de champ
4 - vaste champ de vision
5 - excellent contraste
Le système optique apochromatique permet de corriger l'aberration chromatique de 3 types de couleurs.
Il garantit la réduction et la saturation de la couleur de l'image et en améliore la résolution, le contraste et la profondeur.
- 3 grossissements: gamme de grossissements à 3 niveaux (3,75 X - 7,5 X - 15 X) et une vaste sélection allant d'une vision d'ensemble jusqu'aux moindres détails pour des examens et des traitements plus précis.
- les 2 cercles donnent une mesure rapide des dimensions ou des tissus
- filtre vert intégré: aide à identifier les vaisseaux sanguins
- éclairage à LED: l'illuminateur coaxial à LED fournit une lumière blanche semblable à celle du soleil et renvoie les couleurs réelles. Durée de l'ampoule de plus de 10 000 heures/10 ans pour une efficacité longue durée qui permet d'économiser ampoules et charge électrique.
- caméra intégrée: les images de la caméra incorporée peuvent être transférées directement vers un écran ou une télévision, un ordinateur avec port USB ou stockées su un disque dur.
- design ergonomique pour un fonctionnement précis et de longue durée
Livré entièrement monté et prêt à l'emploi
• 29621 LOGICIEL COLPOSCOPIE - voir page 139

Ampoule à LED avec protection
Molette du filtre vert
Molette de réglage dioptrique
Grossissement en 3 niveaux
Oculaires
Deux cercles pour mesurer la dimension des tissus
Molette rhéostat
Molette pour le blocage de la tête
Poignée pour le réglage de la hauteur
Poignée pour le réglage précis de la mise au point

K061306

Socle léger et compact à 3 roulettes pour faciliter le mouvement. Colposcope de 11 kg seulement.

29624

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Grossissement total : 3,75X, 7,5X, 15X
longueur de focale: 300 mm
Champ de vision: Ø 79 mm, 39 mm, 19 mm
Profondeur de champ: 4,5 mm, 1,13 mm, 0,76 mm
Intensité lumineuse > 25 000 LUX
Rhéostat pour un réglage précis de la mise au point
Oculaires reglables individuellement 16,7 X
Filtre vert sélectionnable par l'utilisateur pour un meilleur contraste
ampoule à LED facile à remplacer
hauteur de travail : de 950 à 1 250 mm
2 molettes pour le réglage de la hauteur (gros/fin)
Alimentation : de 100 à 230 V

CARDIOTOCOGRAPHES POUR HÔPITAUX PC-8000 PRO

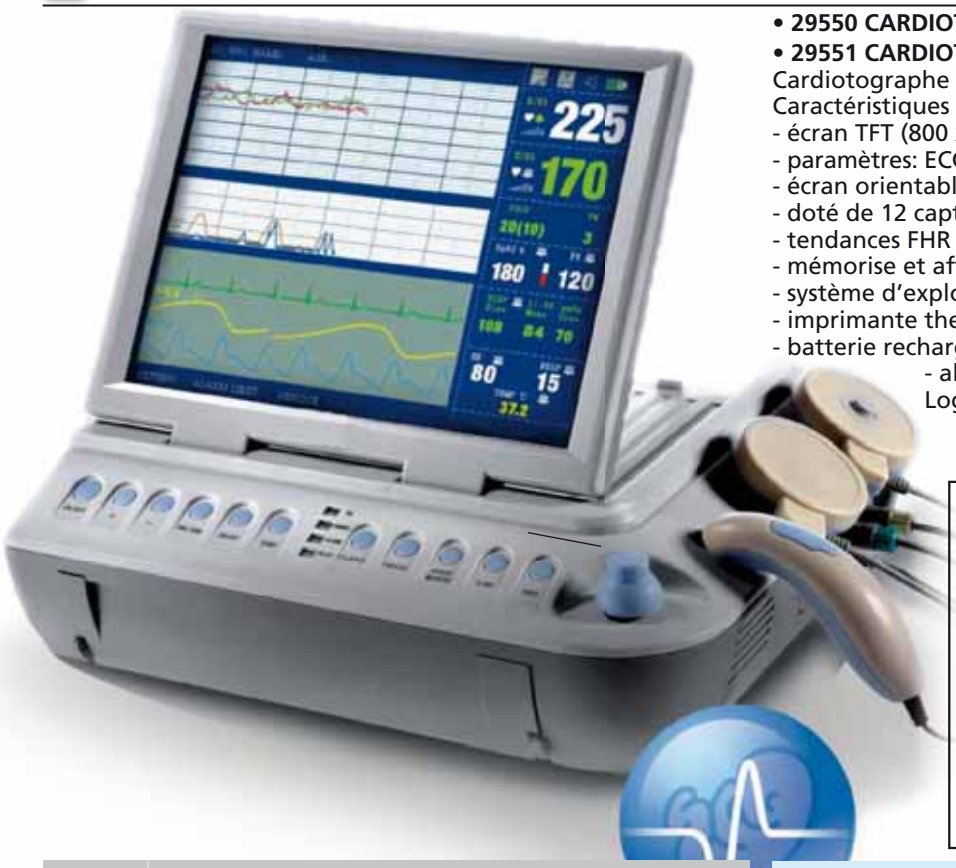

• 29550 CARDIOTOCOGRAPHE MONO PC-8000 PRO
• 29551 CARDIOTOCOGRAPHE GÉMELLAIRE PC-8000 PRO

Cardiotographe conçu pour l'utilisation en milieu hospitalier.
Caractéristiques principales:
- écran TFT (800 x 600 pixel), haute définition, 12,1 pouces
- paramètres: ECG, SpO_2, NIBP, TEMP, RESP, PR, FHR, TOCO et FM
- écran orientable en plusieurs directions, 5 types d'affichage
- doté de 12 capteurs doppler haute sensibilité
- tendances FHR et TOCO
- mémorise et affiche 48 heures d'informations
- système d'exploitation Linux intégré
- imprimante thermique intégrée à haute vitesse
- batterie rechargeable Li-ion interne
- alarmes visuelles et sonores

Logiciel interne en anglais.

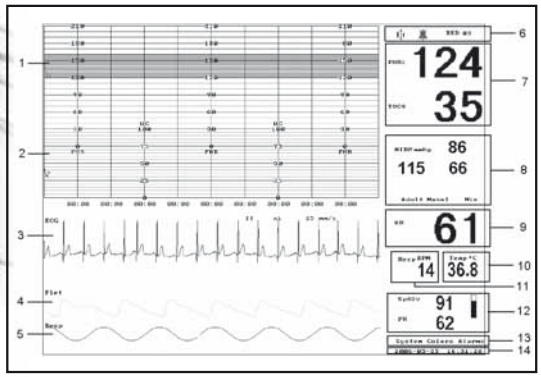

Code GIMA	ACCESSOIRES PC-8000 PRO
29552	Capteur doppler à ultrasons - rechange
29553	Capteur UC/TOCO - rechange
29554	Marqueur d'évènements (capteur mouvements du fœtus) - rechange
29555	Ceinture abdominale - rechange
29556	Papier plié en z 112x100 mm pour 29550*
29557	Papier plié en z 150x100 mm pour 29551**
33297	Electrodes 3M RED DOT™ Ø 6 cm - boîte de 1 000

*20 boîtes de 150 feuilles **25 boîtes de 150 feuilles

ACCESSOIRES STANDARD

Sonde à ultrasons	1	Brassard pour mesurer la pression	1
Capteur contractions utérines	1	Câble d'alimentation	1
Capteur température corporelle	1	Electrodes à usage unique	10
Capteur mouvements du fœtus	1	Manuel utilisateur (GB, IT)	1
Ceinture abdominale	2		
Capteur oxygène dans le sang	1		
Câble de mise à la terre	1		
Gel ultrasons	1		
Câble ECG	1		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surveillance du fœtus:
Sonde à ultrasons
Fréquence de fonctionnement des ultrasons: 1 MHz tolérance ± 5%
ISATA: ≤ 10 mW/cm²
Plage de mesure du pouls du fœtus: 65 ~ 210 bpm
Précision du pouls du fœtus: ± 2 bpm
Alarme RCF: quand la valeur du RCF dépasse la valeur réglée, l'écran lance une alarme en 30 s qui s'arrête en appuyant sur la touche alarme.
Transducteur TOCO
Equilibrage zéro: manuel
Plage de mesure du TOCO: 0 - 100%, tolérance ± 10%
Marqueur
Modalité manuelle et automatique
Surveillance ECG/RESP
Largeur de bande ECG
Mode surveillance: 1 Hz ~25 Hz (+0,4 db –3 db)
Mode diagnostic: 1 Hz ~75 Hz (+0,4 db –3 db)
Plage de mesure ECG: 20 ~ 250 bpm (± 2% ou ± 2 bpm, la plus élevé des 2)
Taux de rejection du mode commun: CMRR ≥ 80 dB
Niveau de bruit ECG: ≤ 30 µVP-P
Courant ECG en entrée: ≤ 0,1 µA
Impédance d'entrée: ≥ 5 MΩ
Constante de temps: mode surveillance: ≥ 0,3 s
mode diagnostic: ≥ 3,2 s
Gain ECG: x1/2 5 mm/mV 5%
x1 10 mm/mV 5%
x2 20 mm/mV 5%
Plage de surveillance RESP: 0 ~ 100 rpm (± 5% ou ± 2 rpm, la plus élevée des 2)
Surveillance NIBP
Technologie de mesure: automatique par méthode d'oscillation
Pression de gonflage initiale du brassard: mode adulte 180 mmHg
Limite de protection de surpression: mode adulte: 300 mmHg
Précision: ±10% ou ±10 mmHg (le plus élevé des 2)
Mode de mesure préprogrammé: manuel, automatique
Intervalles de mesure: 1-240 min. réglable, tolérance d'intervalle: <10 s
Plage de surveillance: pression systolique: 50~240 mmHg
Pression artérielle moyenne: 25~200 mmHg
Pression diastolique: 15~180 mmHg
Précision de mesure: ± 8 mmHg
Surveillance température/SpO2
Capteur SpO2: DEL à longueur d'onde double
Plage de saturation d'oxygène: 0~ 99%
Précision de la saturation di oxygène: 75~ 99% ± 2%
50~ 74% ± 3%
< 50% non définie
Plage de pulsations: 30 ~ 240 fois/minute
Précision: ± 2% ou 2 bpm selon la valeur la plus élevée
Temps de réponse pour la température : ≤ 150 s
Autres informations techniques et paramètres
Alimentation: 100 ~ 250 VAC, 50/60 Hz
Consommation: < 100 VA
Alimentation interne: batterie rechargeable Li-ion
4 heures pour la recharge complète durant la surveillance
6 heures pour la recharge complète si l'écran est éteint
Écran: TFT
Modes d'alarme: alarmes visuelles-sonores
Port réseau: éthernet
Papier plié en z, 112 mm x 90 mm
Protection contre les chocs électriques: classe I
Protection contre les chocs électriques: type BF, parties appliquées CF
Dimensions: 36 x 30 x h 12 cm Poids: 4 kg
Imprimante thermique intégrée
Impression en temps réel de 1/2/3 cm/min, vitesse d'impression (données mémorisées)
Papier plié en z, thermosensible
Id de l'enregistrement, nom, âge, date, heure, vitesse d'impression, etc.
Norme américaine/norme internationale

ÉCRAN COULEUR, CARDIOTOCOGRAPHE MONO OU GÉMELLAIRE

• 29530 CARDIOTOCOGRAPHE MONO - FC1400
• 29531 CARDIOTOCOGRAPHE GÉMELLAIRE - FC1400

Affichage optimal des données
- Écran couleur LCD 320 x 240 (4,3 pouces)
- Détection automatique des mouvements fœtaux et FHR
- Capacité mémoire de 12 heures
- Recommandé après la 30è semaine

Extrêmes précision et accessibilité des données
- Haute précision et large zone de détection
- Fonction défilement à l'écran
- Capteurs étanches et solides, 1 MHz

Impression
- Impression de l'analyse CTG
- Papiers standard et A4 utilisables
- Papier fax normal utilisable
- Vitesse élevée d'impression (50 cm/min)

Autres avantages
- Télésurveillance sans fil pour surveiller jusqu'à 8 lits (Option)
- Compatible PC
- Batterie interne d'une autonomie de 2 heures (Option)
- Adaptateur secteur: 100-240 V, 50/60 Hz

Pour les accessoires, voir ci-dessous

Chariot adapté aux codes 29520, 29530 et 29531

CARDIOTOCOGRAPHE MONO ÉCONOMIQUE

• 29520 CARDIOTOCOGRAPHE GIMA FC 700
Cardiotocographe mono économique

Extrême sensibilité de l'échodoppler
- Haute précision avec fréquence 1 MHz
- Détection automatique/manuelle des mouvements fœtaux
- Examen de la réactivité fœtale automatique de 10 min à 1 h

Impression des données
- Impression de l'analyse CTG
- Papier format A4 avec ligne de perforation
- Papier thermique pour fax standard utilisable
- Vitesse d'impression 1, 2, 3 cm/min

Facile à utiliser
- Fonctionne avec 1 seule touche, facile à configurer
- Alarme (RCF haut/bas)
- maj du logiciel via Internet

ACCESSOIRES STANDARD (29520, 29530, 29531)
Capteur doppler (2 pour le cardiotocographe gémellaire)
Capteur toco, marqueur d'événements, gel, papier pour imprimante, sangles, mode d'emploi

FONCTION D'ANALYSE POUR 29520, 29530, 29531
- Période: période d'essai
- RCF de base moyen (bpm)
- Nombre de contractions (fréquence/h)
- Nombre d'accélérations (fréquence/h)
- Nombre de décélérations (fréquence/h)
- DEC tardive: nombre de décélérations tardives
- DEC précoce: nombre de décélérations précoces
- DEC variable: nombre de décélérations variables
- TACHY: modérée (> 160 bpm): période où le RCF est compris entre environ 160 et 190 (minutes)
- TACHY: sévère (> 190 bpm): période où le RCF est supérieur à 190 (minutes)
- BRADY: modérée (< 110 bpm): période où le RCF est compris entre 90 ~ 110 (minutes)
- BRADY: sévère (< 90 bpm): période où le RCF est inférieur à 90 (minutes)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES CARDIOTOCOGRAPHES (29520, 29530, 29531)

Doppler
Doppler pulsé
Fréquence des ultrasons: 1 MHz
Intensité: < 10 mW/cm²
Plage RCF: 50-240 bpm (± 1 bpm)

Mouvements fœtaux
Source de détection: échodoppler pulsé

Contractions utérines
Réponse en fréquence: CC 0,5 Hz
Témoin de référence (zéro)
Plage de mesure: 0~99 unités

Imprimante
Type peigne thermique
Vitesse d'impression: 1, 2, 3 cm/min
Fonction avance papier

Affichage
LED à 7 segments (29520)
2 canaux (RC, contractions) (29520)
LCD couleur 320x240 (29531)

Indicateurs
Rythme cardiaque avec qualité du signal
Alarme, état impression on/off
Alimentation CA

Configuration
Alarme seuil supérieur/inférieur
Vitesse d'enregistrement, papier quadrillé, Motilité fœtale Marche/Arrêt, Heure/Date, Contraste d'impression, Durée d'impression automatique

Alimentation
ENTRÉE: 100-240 V (50/60 Hz)
296 (l) x 305,5 (H) x 92,5 (P) mm,
Environ 2,9 kg (29520),
3,2 kg (29530-29531)

Liaison externe:
RS-232C: Téléchargement du programme

Pour 29520	Pour 29530-31	ACCESSOIRES POUR CARDIOTOCOGRAPHES
29522	29528	Rouleau papier - 215 mm x 23 m (29522), 152 mm x 25 m (29528)
29523	29532	Capteur doppler de rechange
29524	-	Capteur contractions/toco jusqu'aux modèles FF07XXX
29529	-	Capteur contractions/toco à partir des modèles FF08XXX
-	29533	Capteur doppler de rechange
29519	29519	Chariot avec 2 paniers (hauteur ajustable)
-	29534	Batterie NI-MH, 12 V, 2 600 mA
33747	33747	Adaptateur CA
29525	29525	Sangle 5,3 x 148 cm
Pour 29520	**Pour 29530-31**	**POSTE CENTRAL SANS FIL POUR CARDIOTOCOGRAPHES**
29527	29527	Poste central (PC, moniteur, logiciel, fonction sans fil, kit de connexion) pour gérer jusqu'à 8 cardiotocographes

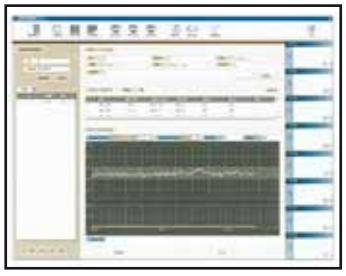

Surveillance sans fil de 8 lits par Bluetooth à partir du système central (distance 10 à 100 m)

DOPPLERS FŒTAUX DE POCHE GIMA - FABRIQUÉS AU ROYAUME-UNI

• 29502 DOPPLER FŒTAL GIMA G2002
Doppler de poche compact, léger et haute sensibilité, avec sonde fœtale de 2 MHz, idéale pour la surveillance fœtale prénatale de routine par les médecins généralistes ou sages-femmes. Il peut être utilisé pour détecter le rythme cardiaque du fœtus dès la 10e semaine de grossesse environ, pour localiser le placenta et faciliter le diagnostic précoce du placenta praevia, pour observer la circulation sanguine dans le cordon ombilical et pour diagnostiquer les grossesses multiples. Les signaux émis par le fœtus sont facilement repérables grâce à la sonde à faisceau étroit, tandis que le traitement interne du signal minimise les artefacts dus au bruit. L'utilisateur peut entendre les battements cardiaques du fœtus grâce aux haut-parleurs intégrés ou au casque en option, le niveau sonore pouvant être ajusté à l'aide d'une molette.
• 29511 INTERRUPTEUR À MEMBRANE MARCHE/ARRÊT pour le code 29502

• 29503 DOPPLER FŒTAL GIMA D2003 avec écran
Mêmes caractéristiques que le code 29502 mais avec traitement intégré du rythme cardiaque fœtal. Le rythme cardiaque fœtal (RCF) s'affiche sur un grand écran LCD tandis que le traitement interne du signal minimise les artefacts dus au bruit.
• 29505 DOPPLER FŒTAL GIMA D2005 avec écran et sonde étanche
Mêmes caractéristiques que le code 29503 mais étanche (sonde et unité principale). Toutes les unités sont livrées dans une pochette pratique avec un tube de gel de couplage et un manuel en GB, ES, FR, DE, IT, GR, PT.
• 29512 INTERRUPTEUR À MEMBRANE MARCHE/ARRÊT pour les codes 29503, 29505

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (CODES 29502 - 29503 - 29505)

Ultrasons:	Fréquence: 2 MHz à onde continue
	Sonde: 2 cristaux et faisceau étroit
	Puissance de sortie: < 10 mW/mm² SATA
	Réponse audio: 300 Hz - 1 kHz
	Autocorrélation (code 23503 et 29505)
Rythme cardiaque fœtal:	50-210 bpm (codes 25903, 29505) 60-210 bpm (29502)
	résolution ± 1 bpm, précision ± 2 bpm
Commandes:	Touches: 1 touche (marche/arrêt de l'unité)
	Commandes: molette volume
Indicateurs:	Affichage sur écran LCD à 3 chiffres du RCF (codes 25903, 29505)
	Icone des pulsations du RCF (codes 25903, 29505),
	icone batterie faible
Alimentation:	Pile alcaline au manganèse 9 V
	Autonomie théorique: > 8 heures (codes 29503, 29505)
Sortie:	Casque: sortie audio vers casque en option
	Série: interface RS232 (codes 29503, 29505)-jack 35 mm

Matière: ABS/Noryl
Dimensions: 150 mm par 75 mm Poids: 295 g (sonde comprise)
Classification: Classe I Type B - CEI 60601-I CE 0120
Garantie: 2 ans (sonde et câble inclus) Fabriqué au Royaume-Uni

DOPPLERS SONOTRAX

SONDES ÉTANCHES
2 MHZ, 3 MHZ, 4 MHZ, 8 MHZ
COMPATIBLES

29493

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 32 x 85 x 138 mm
Poids: 290 g (pile incluse)
Plage de rythme cardiaque: 50-210 bpm
Résolution: 1 bpm
Écran LCD: 45 x 25 mm (code 29491-93 seulement)
Modes manuel et automatique
Durée d'enregistrement: 480 s / 240 s
Puissance de sortie audio: 0,5 W
Coupure auto au bout de 1 minute
Manuel en GB, IT - sur demande: DE, ES, FR, PT

Code GIMA	DOPPLERS ET SONDES INTERCHANGEABLES SANS LATEX
29490	DOPPLER SONOTRAX LITE - sans sonde - avec sac
29491	DOPPLER SONOTRAX BASIC - avec écran - sans sonde avec sac de transport
29493	DOPPLER SONOTRAX PRO II avec écran rétroéclairé, enregistreur audio intégré et piles rechargeables par chargeur - sans sonde avec sac de transport
29496	Sonde étanche 2 MHz - gynécologie
29497	Sonde étanche 3 MHz - gynécologie
29498	Sonde étanche 4 MHz - vasculaire
29499	Sonde étanche 8 MHz - vasculaire

DOPPLER GIMA BABY SOUND

LOGICIEL POUR LA SAUVEGARDE DES DONNÉES SUR PC

• 29506 DOPPLER FŒTAL GIMA BABY SOUND avec écran et sonde 1 MHz - interchangeable
- Portable et léger
- Haut-parleur intégré pour entendre les battements de cœur du fœtus
- Affichage numérique avec courbe graphique du RCF
- Arrêt automatique
- Écran LCD rétroéclairé
- Affichage de la date, de l'heure et de l'état des piles
- Alerte sonore et visuelle pour le RCF
- Mémoire: 8 heures de données
- Sortie audio
- Traitement numérique des signaux
- Sonde haute sensibilité
- Fréquence de fonctionnement de 1 MHz ou 2/2,5
- Stockage et rappel du RCF, jusqu'à 16 heures
- Enregistrement

Ce dispositif permet d'écouter les battements du cœur d'un fœtus dès la 20e semaine de grossesse grâce à son haut-parleur intégré, et de déceler d'éventuels problèmes graves du fœtus (detection non régulière de la frequence cardiaque dès 10-12 semaines). Utilisation à domicile et en milieu hospitalier. Livré avec un flacon de gel, 3 piles AA et un mode d'emploi.
• 29507 SONDE POUR DOPPLER 2,0/2,5 MHz
• 29508 SONDE CARDIOTOCOGRAPHE 1 MHz
Ce Doppler peut être utilisé comme un cardiotocographe portable avec la sonde cardiotocographe 1 MHz. Adapté au suivi à long terme et plus précis que la sonde pour Doppler.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement des ultrasons: 1 MHz ± 5 %				
Rythme cardiaque fœtal:	plage:	50-210 bpm		
	résolution:	1 bpm		
	précision:	± 2 bpm		
Alarme:	seuil supérieur:	160 bpm	seuil inférieur:	120 bpm
Intensité des ultrasons:		< 5 mm/cm²		
Dimensions:	145 x 74 x 29 mm		Poids:	350 g
Alimentation:	3 piles AA			

RECTOSCOPE ET ANUSCOPE JETABLES

• 25953 TÊTE D'ÉCLAIRAGE PAR FIBRE OPTIQUE
Cette tête s'adapte parfaitement et éclaire les anuscopes, rectoscopes et proctoscopes jetables GIMA, HEINE, WELCH ALLYN et GPS. Elle peut être connectée à une source lumineuse par un câble en fibre optique ou un système d'éclairage à LED. Voir page 164-165.
• 25947 ANUSCOPE JETABLE - stérilisé - boîte de 60 unités
Longueur 10 cm, avec stylet Ø 17 mm, adapté au traitement des hémorroïdes.
• 25949 RECTOSCOPE JETABLE - stérilisé - boîte de 50 unités
Longueur 25 cm, avec stylet Ø 17 mm, gradué en cm, éclairage par l'extrémité distale grâce au tube noir opaque placé à l'intérieur du corps transparent qui permet un éclairage sans ombre.
Voir proctoscope jetable page 152.

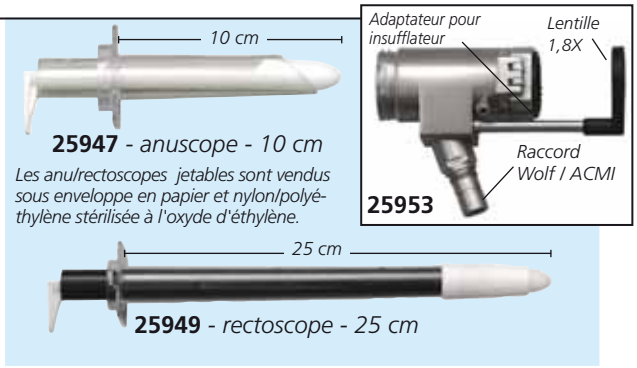

25947 - *anuscope - 10 cm*

Les anu/rectoscopes jetables sont vendus sous enveloppe en papier et nylon/polyéthylène stérilisée à l'oxyde d'éthylène.

25949 - *rectoscope - 25 cm*

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE: SOURCE LUMINEUSE OU POIGNÉE ÉCLAIRÉE

côté instrument **30798** *côté fibre optique*

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
Tous les produits de cette page sont livrés avec un raccord pour lampe Acmi/Wolf.
Pour obtenir l'éclairage, procurez-vous un adaptateur Wolf (30841), un câble en fibre optique (30818-30826), un adaptateur pour source lumineuse (30830) et une source lumineuse (30801-30802). Voir pages 164-165. Pour une meilleure prise en main de l'instrument en cours d'utilisation, nous vous recommandons la poignée ci-dessous, qui peut être placée entre l'instrument et le câble en fibre optique.
• 30798 POIGNÉE pour anu/procto/rectoscopes et sigmoïdoscopes. Nécessite source lumineuse. Vous pouvez également choisir une solution d'éclairage plus économique, comprenant une poignée.
• 30799 POIGNÉE ÉCLAIRÉE 6 VOLTS - AMPOULE HALOGÈNE
Source lumineuse indépendante pour instruments à fibre optique. Connexion directe avec tous les instruments à F.O. dans cette page. **• 30800 AMPOULE HALOGÈNE- rechange pour 30799**

ANUSCOPES, PROCTOSCOPES À F. O.

ANUSCOPES À FIBRE OPTIQUE

PROCTOSCOPE À FIBRE OPTIQUE

Code GIMA	ANUSCOPES - PROCTOSCOPES À FIBRE OPTIQUE	ADAPTATEUR inclus
29400	Anuscope à F. O. Ø 15 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acmi/Storz
29401	Anuscope à F. O. Ø 20 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acmi/Storz
29402	Anuscope à F. O. Ø 25 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acmi/Storz
29403	Jeu de 3 anuscopes à F. O. avec raccord Wolf et Storz dans valisette	
29405	Proctoscope à F. O. Ø 20 x 130 mm - avec obturateur avec 2,0X et adaptateurs Wolf, Acmi et Storz	
30840	Adaptateur Endo Storz - pour connecter aux câbles F.O. GIMA	

**Mêmes raccord que ci-après - voir adaptateurs p. 165*

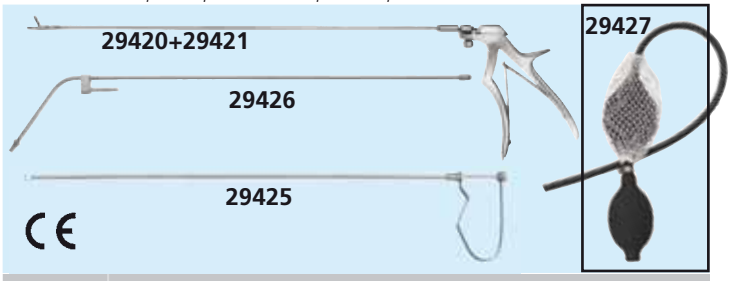

Code GIMA	ACCESSOIRES POUR ANUSCOPES, PROCTOSCOPES ET SIGMOÏDOSCOPES À FIBRE OPTIQUE
29420	Poignée pour pince à biopsie
29421	Pince à biopsie 3,5 x 8 mm Cuillères - 420 mm
29422	Pince à biopsie 4 mm - Mâchoires coupantes - 420 mm
29425	Pince à pansement - 400 mm
29426	Tube d'aspiration - 400 mm
29427	Insufflateur à double poire

SIGMOÏDOSCOPES À FIBRE OPTIQUE

Code GIMA	SIGMOÏDOSCOPES À F. O. AVEC LENTILLE PIVOTANTE POUR GROSSISSEMENT 2X	ADAPTATEUR inclus
29410	Sigmoïdoscope à F. O. 12 x 200 mm	Wolf/Acmi/Storz
29411	Sigmoïdoscope à F. O. 16 x 250 mm	Wolf/Acmi/Storz
29412	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 200 mm	Wolf/Acmi/Storz
29413	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 250 mm	Wolf/Acmi/Storz
29414	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 300 mm	Wolf/Acmi/Storz
30840	Adaptateurs Endo Storz - pour connecter aux câbles F.O.	

Pour connecter le sigmoïdoscope à la source lumineuse GIMA (30801, 30802) il vous faut: câble F.O. (30818, 30826), adaptateur (30830) pour connecter le câble à la source lumineuse et 2 adaptateurs (30840, 30844) pour connecter le sigmoïdoscope au cable F.O.

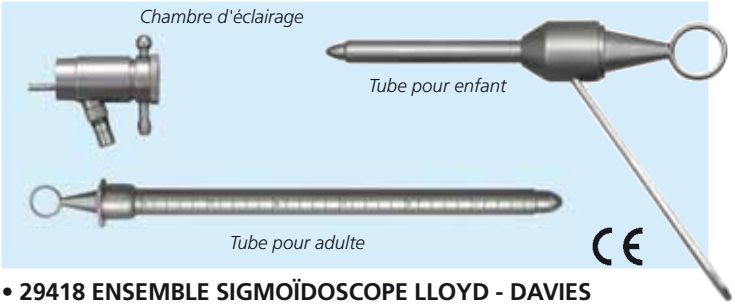

• 29418 ENSEMBLE SIGMOÏDOSCOPE LLOYD - DAVIES
L'ensemble comprend 1 chambre d'éclairage, avec raccord Acmi/Wolf/Storz, 1 tube adulte Ø 20 x 300 mm, 1 tube adolescent Ø 16 x 250 mm et 1 tube enfant Ø 10 x 75 mm, dans une pochette souple.
Pour éclairer l'ensemble, vous pouvez utiliser une poignée éclairée (code 30799) ou la source lumineuse GIMA (30801), un adaptateur pour source lumineuse (30830), un câble en F. O. (30818) et un adaptateur (30840).

TESTS DE GROSSESSE: TYPE STYLO ET BANDELETTES URINAIRES

Ligne complète de tests de grossesse, destinés à la vente sans ordonnance (autodiagnostic) et à une utilisation professionnelle à l'hôpital ou en cabinet. Livrés dans une boîte en carton avec manuel multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT).
Principales caractéristiques des tests de grossesse:
- emballage individuel hermétique
- très rapide: résultat positif détecté en 1 min. (norme 3 min)
- détection précoce: utilisable dès le 1er jour de retard de règles
- fiabilité: 99 %
- sensibilité: 25 mUI/ml
- testé cliniquement



Code GIMA	TESTS DE GROSSESSE	Type	Conditionnement
29101	AUTODIAGNOSTIC	band. 4 mm	boîte de 4 unités
29104	AUTODIAGNOSTIC	stylo	boîte de 1 unité
29107	AUTODIAGNOSTIC	stylo	boîte de 2 unités
29108	TEST PROFESSIONNEL	stylo	boîte de 25 unités
29100	TEST PROFESSIONNEL	band. 4 mm	boîte de 50 unités

EMBALLAGE PERSONNALISÉ, MODE D'EMPLOI ET CERTIFICATION CE 0197 POUR AUTODIAGNOSTIC minimum 3 000 unités.

OVULATION - TESTS DE FERTILITÉ ET TEST DE MÉNOPAUSE

TEST DE MÉNOPAUSE:
Test haute sensibilité pour la détection de la FSH dans l'urine, testé cliniquement. Sensibilité: 25 mUI/ml.
OVULATION - TEST DE FERTILITÉ:
Facile à utiliser, destiné à un usage professionnel ou à la vente sans ordonnance pour autodiagnostic.
Test de détection précoce, précis à 99,9% et testé cliniquement. Sensibilité: 40 mUI/ml.
Livrés dans une boîte en carton avec manuel multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT).
- **29131 PRÉSENTOIR - anglais - vide**
- **29130 PRÉSENTOIR - italien - vide**

Adapté à tous les tests autodiagnostic de gynécologie.

Code GIMA	TESTS D'OVULATION	Type	Conditionnement
29112	AUTODIAGNOSTIC	stylo	boîte de 5 unités
29114	AUTODIAGNOSTIC	band. 4 mm	boîte de 6 unités
29113	TEST PROFESSIONNEL	band. 4 mm	boîte de 50 unités
Code GIMA	**TEST DE MÉNOPAUSE**	**Type**	**Conditionnement**
29109	AUTODIAGNOSTIC	stylo	boîte de 2 unités

VOIR THERMOMÈTRE BASAL POUR CONTRÔLE DE LA FERTILITÉ - PAGE 65

AVERTISSEMENT: LA DATE D'EXPIRATION DES TESTS EST RAPPROCHÉE DANS LE TEMPS. Lors de leur fabrication, ils ont une date d'expiration fixée à 24 mois.
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à 22 mois.

DIAGNOSTIC RAPIDE DE CHLAMYDIA

• 29117 TEST DE DIAGNOSTIC DE CHLAMYDIA - boîte de 20 tests
Résultat précis en 10 minutes, permettant un diagnostic immédiat par le médecin. Sensibilité et spécificité élevées. Chaque boîte contient 20 tests, des réactifs, des écouvillons cervicaux, des tubes, des pipettes et un mode d'emploi.
Utilisation professionnelle.

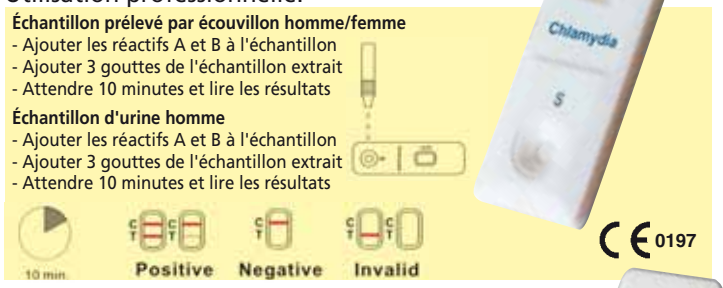
Échantillon prélevé par écouvillon homme/femme
- Ajouter les réactifs A et B à l'échantillon
- Ajouter 3 gouttes de l'échantillon extrait
- Attendre 10 minutes et lire les résultats
Échantillon d'urine homme
- Ajouter les réactifs A et B à l'échantillon
- Ajouter 3 gouttes de l'échantillon extrait
- Attendre 10 minutes et lire les résultats
10 min.
Positive
Negative
Invalid
Chlamydia
CE 0197

DIAGNOSTIC RAPIDE DE LA SYPHILIS

• 29118 TEST DE DIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS - boîte de 40 tests
Rapide et facile à utiliser: protocole d'essai sur sang total, résultat en 10 minutes à peine pour une utilisation en cabinet.
Précis: sensibilité 99,7% et spécificité 99,6%, antigènes recombinés, détecte les anticorps IgG et IgM, antigènes tréponémiques.
Pratique: protocole en 2 étapes et interprétation visuelle.
Utilisation professionnelle.

DIAGNOSTIC DE CANDIDA ALBICANS

• 29105 TEST DE DIAGNOSTIC DE CANDIDA - boîte de 20 tests
Test rapide par immunochromatographie sur frottis vaginal. Facile à réaliser, capable d'identifier la présence de Candida en 10 à 20 min. seulement au moyen d'anticorps spécifiques. Des études indépendantes ont démontré une sensibilité supérieure à 98 % et une spécificité supérieure à 94 % par rapport aux procédés de référence pour l'identification de microbes (par ex. BD Affirm, É-U). Il se classe parmi les meilleurs tests rapides en terme de reproductibilité. 50% des femmes sont touchées au moins une fois dans leur vie par la Candida, dont les symptômes peuvent être confondus avec ceux d'une vaginose bactérienne ou d'une autre vaginite. Ce test, utilisé en association avec le test de pH vaginal (voir code 29110), permet de les distinguer. Utilisation professionnelle.

• 29106 TEST D'AUTO-DIAGNOSTIC DE CANDIDA - boîte de 1 test
Mêmes caractéristiques que le code 29105 mais conditionné dans une boîte individuelle pour autotest.

TEST STREP-B

• 29123 TEST STREP-B - boîte de 20 tests
Test de dépistage utilisé pour la détection de streptocoques B dans les échantillons de liquides vaginaux. Les streptocoques de Group B (GBS) ou Streptococcus Agalactiae comptent parmi les causes les plus fréquentes d'infections mortelles chez les nouveaux nés. Pour le diagnostic, alors que les méthodes habituelles nécessitent entre 24 et 48 h, ces tests sont rapides et fiables et représentent une alternative au POC. Une spécificité absolue et une sensitivité de $1{,}0x10^5$ micro-organismes caractérisent ce test. Utilisation professionnelle.

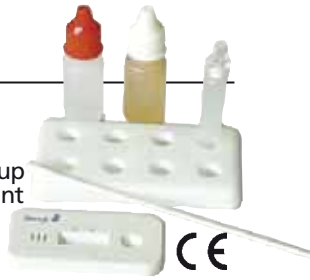

TROUSSE DE TEST VAGINITE

Le test comprend:
1 test + écouvillon vaginal + échantillon de fluide (solution tampon) en boîte individuelle + mode d'emploi en GB / IT

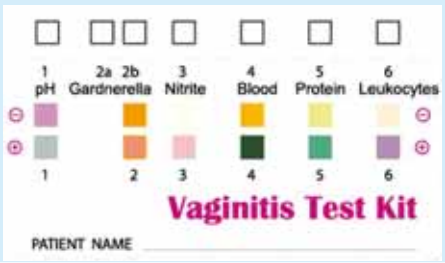

• 29111 TROUSSE DE TEST VAGINITE
Test unique, facile à utiliser et révolutionnaire pour gynécologues et soignants. Identifie les causes de l'inflammation/infection vaginale en à peine 10 minutes. Remplace les tests bactériens traditionnels, toujours très longs, pour un coût dix fois inférieur. Si nécessaire, diluer l'échantillon de fluide vaginal dans une solution tampon puis transférer le tout sur le tampon réactif. Le mode d'emploi inclut un guide de lecture des résultats et peut être utilisé pour reconnaître une vaginite à Trichomonas, bactéries gram-négatives, Gardnerella, Chlamydia et bactérienne grave. Utilisation professionnelle.

TEST DE pH VAGINAL

Le test comprend:
10 écouvillons en coton + 10 tampons réactifs en emballage individuel et un mode d'emploi (GB / IT)

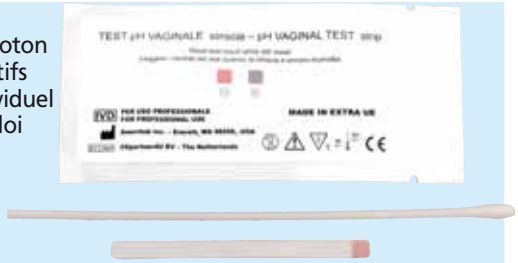

• 29110 TEST DE pH VAGINAL - boîte de 10 unités.
Test rapide de détermination du pH vaginal. Un test de routine simple pour vérifier en 1 minute si le pH vaginal est bien dans les limites physiologiques (< 4,7).
Une augmentation du niveau de pH peut refléter une modification du milieu vaginal et indiquer la présence d'une vaginite.
Test idéal pour les femmes enceintes et celles souffrant de maladies particulières telles que le diabète.
Utilisation professionnelle.

PESSAIRES EN CAOUTCHOUC ET SILICONE POUR PROLAPSUS UTÉRIN - SANS LATEX

Emballés individuellement dans une boîte en carton avec mode d'emploi en anglais

Code GIMA	PESSAIRES EN CAOUTCHOUC - AUTOCLAVABLE
29882	Pessaire en caoutchouc Ø 55 mm
29963	Pessaire en caoutchouc Ø 60 mm
29964	Pessaire en caoutchouc Ø 65 mm
29965	Pessaire en caoutchouc Ø 70 mm
29966	Pessaire en caoutchouc Ø 75 mm
29967	Pessaire en caoutchouc Ø 80 mm
29968	Pessaire en caoutchouc Ø 85 mm
29969	Pessaire en caoutchouc Ø 90 mm
29884	Pessaire en caoutchouc Ø 95 mm
	PESSAIRES EN SILICONE - AUTOCLAVABLE
29893	Pessaire en silicone Ø 60 mm
29894	Pessaire en silicone Ø 65 mm
29895	Pessaire en silicone Ø 70 mm
29896	Pessaire en silicone Ø 75 mm
29897	Pessaire en silicone Ø 80 mm

CURETTES D'ASPIRATION INTRA-UTÉRINE DE TYPE «KARMAN» ET «BERKELEY»

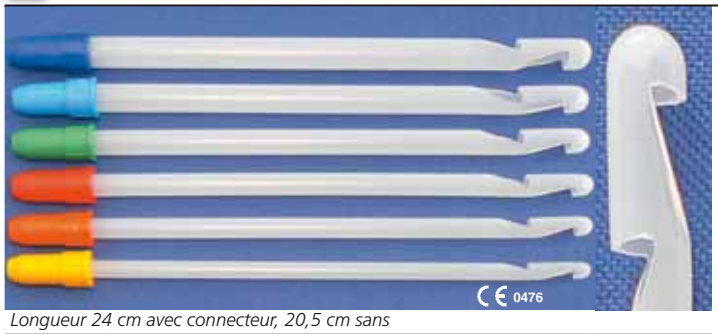

Longueur 24 cm avec connecteur, 20,5 cm sans

Code GIMA	CURETTES DE TYPE « KARMAN » SOUPLES - JETABLES - STÉRILES	Commande minimum
29860	Curette de Karman n° 6 - 6 mm x 24 cm	boîte de 20
29861	Curette de Karman n° 7 - 7 mm x 24 cm	boîte de 20
29862	Curette de Karman n° 8 - 8 mm x 24 cm	boîte de 20
29863	Curette de Karman n° 9 - 9 mm x 24 cm	boîte de 20
29864	Curette de Karman n° 10 - 10 mm x 24 cm	boîte de 20
29865	Curette de Karman n° 11 - 11 mm x 24 cm	boîte de 20
29866	Curette de Karman n° 12 - 12 mm x 24 cm	boîte de 20

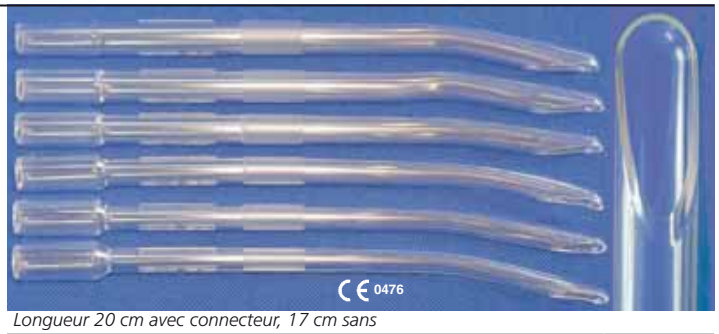

Longueur 20 cm avec connecteur, 17 cm sans

Code GIMA	CURETTES DE TYPE « BERKELEY » COURBES - RIGIDES - JETABLES - STÉRILES	Commande minimum
29870	Curette de Berkeley n° 7 - Ø 7 mm x 20 cm	boîte de 20
29871	Curette de Berkeley n° 8 - Ø 8 mm x 20 cm	boîte de 20
29872	Curette de Berkeley n° 9 - Ø 9 mm x 20 cm	boîte de 20
29873	Curette de Berkeley n° 10 - Ø 10 mm x 20 cm	boîte de 20
29874	Curette de Berkeley n° 11 - Ø 11 mm x 20 cm	boîte de 20
29875	Curette de Berkeley n° 12 - Ø 12 mm x 20 cm	boîte de 20

• 29918 SERINGUE D'ASPIRATION - unidirectionnelle et autobloquante
Seringue spéciale avec adaptateur approprié pour une utilisation avec les curettes de Karman et de Berkeley de toutes marques. Valve unidirectionnelle autobloquante pour une utilisation plus facile et plus sûre. Jetable et stérile, capacité de 60 ml.

Commande minimum: 10 unités

AMNIOSCOPE: TUBES ET APPAREIL

30801
Pour éclairer les tubes d'amnioscope vous pouvez utiliser une source lumineuse GIMA et des câbles en fibre optique voir page 165
150
30818
CE
29970

• 29970 JEU D'AMNIOSCOPE inclut 29971/2/3/5 et 30840
Jeu de 3 tubes d'amnioscope avec obturateur de 200 mm de long, Ø 12, 16 et 20 mm et bride pour éclairage par fibre optique. Les tubes sont gradués en cm, dotés d'une extrémité arrondie et supportent tous les procédés de stérilisation. Pour les éclairer, vous pouvez utiliser la source lumineuse GIMA 150 (code 30801), un adaptateur (code 30830), un câble en F. O. (code 30818), le tube simple a d'un adaptateur pour bride (code 30840), et bride (29975).

• 29971 TUBE D'AMNIOSCOPE 12 x 24 x 200 mm
• 29972 TUBE D'AMNIOSCOPE 16 x 24 x 200 mm
• 29973 TUBE D'AMNIOSCOPE 20 x 24 x 200 mm
• 29975 BRIDE ANGULAIRE POUR FIXATION DE LAMPE

SALPINGOGRAPHE DE SCHULTZE

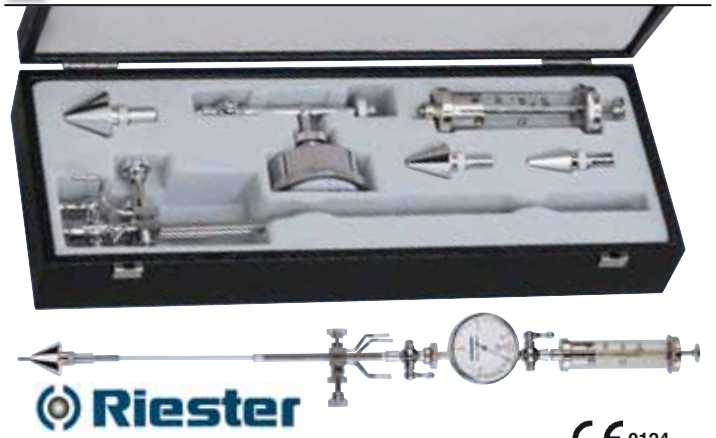

• 29780 SALPINGOGRAPHE CE 0124
Instrument pour hystérosalpingographie et insufflation tubaire, type Prof. Gunter K. F. Schultze de Berlin. Fabriqué en Allemagne.

• 29784 SERINGUE POUR HYSTÉROGRAPHIE - 10 cc - raccord LUER LOCK - rechange

HYSTÉROSALPINGOGRAPHE: ACCESSOIRES STANDARD

Manomètre pour hystérographie
Tige à crémaillère
Seringue pour hystérographie 10 cc Luer Lock
3 cônes interchangeables (petit/moyen/grand)

STÉTHOSCOPES OBSTÉTRICAUX

• 32501 STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL COURT - hêtre
• 32502 STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL LONG - hêtre
Ces stéthoscopes sont fabriqués à la main, en hêtre sélectionné avec soin et séché pendant au moins 3 ans. Leur finition en vernis transparent spécial est parfaite. Conditionnement en boîte individuelle. Fabriqué en Allemagne.

• 32505 STÉTHOSCOPE DE PINARD - aluminium

VENTOUSES

• 29980 VENTOUSE EN SILICONE Ø 60 x 210 mm
• 29981 VENTOUSE EN SILICONE Ø 70 x 210 mm CE 0434
Fabriquées en silicone de qualité médicale.

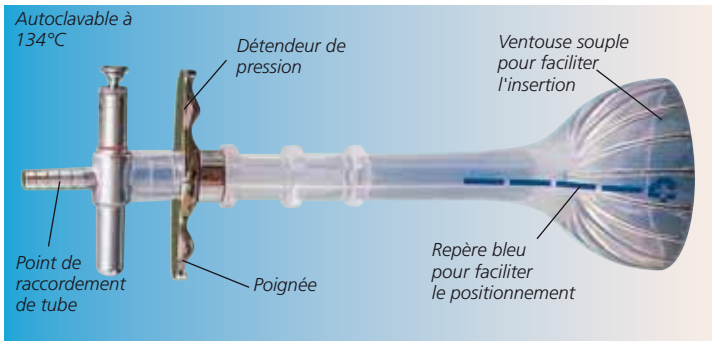

PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX

• **29513 PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX - transparentes - boîte de 50**
• **29514 PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX - transparentes - boîte de 500**
Pour sondes d'échographie et dopplers. Conditionnement en sachet plastique individuel. Longueur 17 cm, Ø 3,3 cm.

PINCE OMBILICALE

0373
29942
Pince ombilicale fiable à 100 % évitant toute réouverture accidentelle. Ne peut être rouverte qu'en coupant la partie arrière

• **29942 PINCE OMBILICALE X-SAFE - stérile**
Pince ombilicale jetable grande taille, permet le clampage correct de tous les cordons ombilicaux et empêche leur sortie de la pince de fermeture. Conditionnement individuel sous cellophane (nylon/polyéthylène) et papier médical pour garantir à l'utilisateur des conditions hygiéniques sûres. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Fabriquée en Italie.
Commande minimum: boîte de 500 unités.

AIGUILLES POUR AMNIOCENTÈSE

Pour le prélèvement transabdominal de liquide amniotique et le diagnostic prénatal de troubles génétiques du fœtus. Utilisées pour les études cytogénétiques et biochimiques. La pointe effilée de l'aiguille permet une insertion facile et atraumatique. Le mandrin est doté d'un embout détectable par ultrasons pour une insertion écho-guidée et les différentes tailles d'aiguille sont identifiables grâce à un code de couleur. L'aiguille comporte une butée ajustable pour déterminer la profondeur d'insertion et un raccord Luer Lock femelle pour prélever le liquide amniotique à l'aide d'une seringue. Fabriquées en Italie.

Code GIMA	AIGUILLES POUR AMNIOCENTÈSE - STÉRILES
29630	Aiguille 20 G x 100 mm
29631	Aiguille 20 G x 120 mm
29632	Aiguille 20 G x 150 mm
29633	Aiguille 20 G x 180 mm
29634	Aiguille 21 G x 120 mm

CE 0476



PERFORATEUR DE MEMBRANE

• **29945 PERFORATEUR DE MEMBRANE AMNIOTIQUE - stérile**
Perforateur amniotique jetable. Ce système est parfaitement sûr et évite toute lésion du fœtus.
Conditionnement en enveloppe stérile individuelle. CE 0373

BRACELETS D'IDENTIFICATION

Code GIMA	BRACELETS D'IDENTIFICATION	Coloris	Commande minimum
29936	Nouveau-né	Bleu clair	boîte de 100
29937	Nouveau-né	Rose	boîte de 100
29938	Mère	Bleu clair	boîte de 100
29939	Mère	Rose	boîte de 100

CUPULES POUR HYSTÉROGRAPHIE ET SERINGUE SIFT À VIS

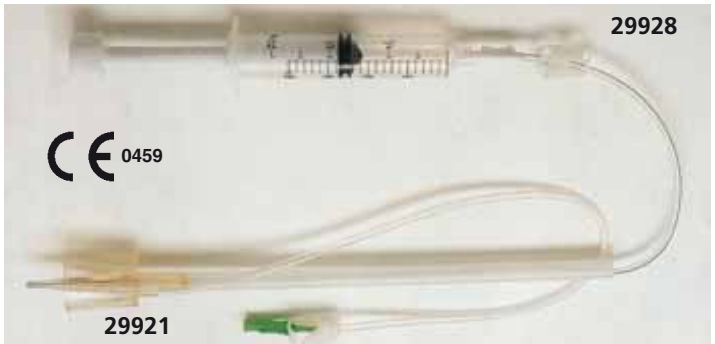

Code GIMA	CUPULES POUR HYSTÉROGRAPHIE JETABLES - STÉRILES	Commande minimum
29920	Cupules 25 mm	10 unités
29921	Cupules 30 mm	10 unités
29922	Cupules 35 mm	10 unités
29923	Connecteur pour cupules - stérile	10 unités
29928	Seringue Sift pour cupules	10 unités

CUPULES POUR HYSTÉROGRAPHIE - sans latex
Le dispositif se compose d'une cupule tronconique transparente et d'une canule centrale conique; il est doté d'un bras de manipulation flexible de 25 cm de long relié à la cupule et de 2 tubes avec raccords. L'un permet de créer le vide, tandis que l'autre injecte le produit radio-opaque. Une parfaite adhérence au col de l'utérus par auto-centrage est garantie par la forme tronconique de la cupule et l'application progressive d'un vide à la cupule. L'unité d'aspiration cupule/canule est radio-transparente et permet de contrôler la zone proximale endocervicale. Le radiologue peut manipuler le champ radioactif à distance tout en immobilisant confortablement l'utérus.
SERINGUE SIFT À VIS
L'agent de contraste est injecté en tournant la seringue, équipée d'un pas de vis, pour permettre l'injection facile et régulière du contraste.
Si vous utilisez une cupule avec notre seringue Sift, le raccord n'est pas nécessaire.

SPATULES D'AYRE - BOIS DE BOULEAU

Code GIMA	SPATULES D'AYRE - BOIS	Longueur	Commande minimum
29743	Spatule d'Ayre A *5 boîtes de 100 unités = 500 unités*	18 cm	500 unités
29745	Spatule d'Ayre A stérile *Emballée individuellement dans des sachets stériles, par boîte de 100*	18 cm	100 unités

SPATULES D'AYRE - PLASTIQUE

Pour le prélèvement des cellules exocervicales et du fornix postérieur dans les protocoles de dépistage du cancer de l'utérus.

29746

Code GIMA	SPATULES D'AYRE - PLASTIQUE	Matière de la tige	Longueur de la tige	Commande minimum
29746	Spatule d'Ayre *Emballée dans des sacs plastiques de 25 unités, en carton de 400 unités*	PP	22 cm	400 unités
29748	Spatule d'Ayre A stérile *Emballée individuellement dans des sachets stériles, par boîte de 100*	PP	18,8 cm	100 unités
29749	Spatule d'Ayre B stérile *Emballée individuellement dans des sachets stériles, par boîte de 100*	PP	18,8 cm	100 unités

BROSSETTES GIMA - FABRIQUÉES EN ITALIE

- **29739 BROSSETTE GIMA - conique - sachet de 25 unités**
- **29740 BROSSETTE GIMA - conique - boîte de 400 unités**

Ces brossettes endocervicales jetables permettent de prélever efficacement des échantillons des surfaces vulvaire, endocervicale et nasale pour examen cytologique/microbiologique. Non stérile. Conditionnement en sachets plastiques de 25 unités, en carton de 400 unités.

- **29742 BROSSE GIMA - conique - STÉRILE - boîte de 500 unités**

Comme pour le code 29740, conditionnement individuel sous sachet plastique stérile. Les 2 articles sont fabriqués en Italie.

BROSSETTES GIMA - STÉRILES

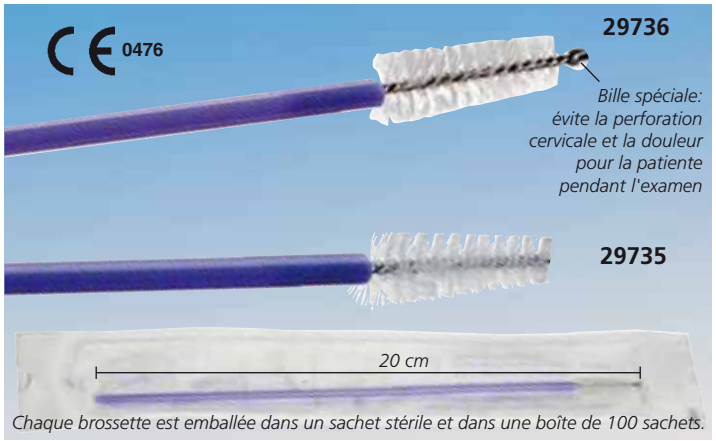

Chaque brossette est emballée dans un sachet stérile et dans une boîte de 100 sachets.

- **29735 BROSSETTE GIMA B - stérile - boîte de 100 unités**
- **29736 BROSSETTE À BILLE GIMA - stérile - boîte de 100 unités**

Chaque brossette est emballée en sachet stérile dans une boîte de 100 sachets.

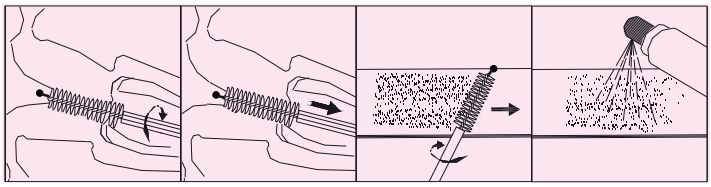

COTONS-TIGES

Code GIMA	COTONS-TIGES	Matière de la tige	Ø du coton	Longueur de la tige	Commande minimum
29750	Coton-tige *Emballé en sac plastique de 25 unités, en carton de 400 unités.*	Plastique	1 cm	20 cm	400 unités
29753	Coton-tige stérile *Emballé en boîte de 100 unités.*	Plastique	0,5 cm	15 cm	100 unités
29754	Coton-tige *Emballé en sac plastique de 100 unités, en carton de 1 000 unités.*	Bois	0,5 cm	15 cm	1 000 unités
29756	Coton-tige *Emballé en sac plastique de 50 unités, en carton de 500 unités*	Bois	1 cm	15 cm	500 unités

BROSSE WALLACH - COLLECTEUR GIMA

Grâce à la Brosse Wallach, un simple mouvement rotatif suffit pour prélever un échantillon de cellules endocervicales et exocervicales totales, y compris la zone de transformation, de manière moins traumatique.

29738

Code GIMA	BROSSES	Matière	Longueur de la tige	Commande minimum
29738	Brosse Wallach *Emballée en sacs de 100 unités.*	Plastique	16 cm	100 unités
29737	Collecteur stérile GIMA *Emballé individuellement dans un sachet stérile, par boîte de 100.*	Plastique	17 cm	100 unités

BROSSE POUR COL DE L'UTÉRUS - CURETTE POUR COL DE L'UTÉRUS

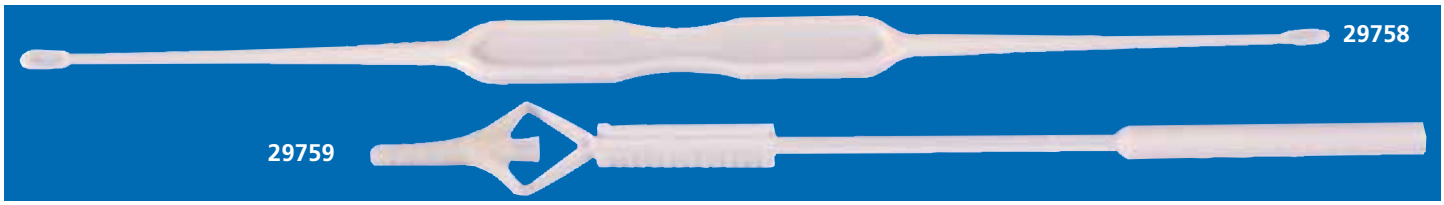

• 29758 CURETTE POUR COL DE L'UTÉRUS - stérile - boîte de 100 unités

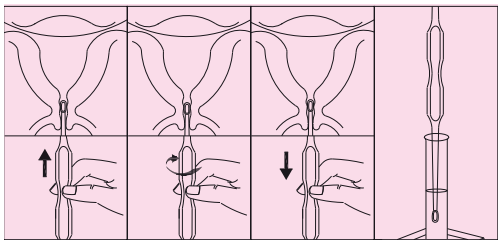

CE 0476

• 29759 BROSSE POUR COL DE L'UTÉRUS - stérile - boîte de 100 unités
Avec manche et partie en losange rétractable

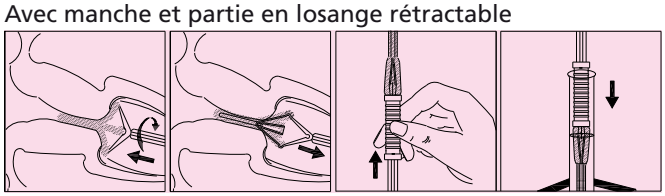

CANULES POUR PRÉLÈVEMENT ENDOMÉTRIAL

Bout arrondi pour une insertion facile et sans heurt, 1 ou 4 trous

Dispositif pour prélèvement endométrial (mucus - sperme)

CE 0476 FDA **29826**

Graduation en cm pour une mesure facile de la longueur de l'utérus

Dispositif pour prélèvement endométrial pour examen cytologique

CE 0123

L'hystérométrie peut être mesurée suivant des points de référence de 3,6 et 9 cm situés sur le dispositif

29940

Pointe terminée par 2 branches asymétriques présentant des saillies pour le prélèvement



29940

• 29826 PIPELLE 1 trou - jetable, stérile
• 29827 PIPELLE 4 trous - jetable, stérile
Pour prélèvement cytologique endométrial ou de sperme pour les tests post-coïtaux.
Il permet un examen facile et sans douleur de l'endomètre tout en évitant une dilatation et une traction du col de l'utérus.
Ø externe 2 ±0,5 mm - longueur 27,5 cm
Usage unique, stérile.
Commande minimum: 100 unités

• 29940 ENDOGYN - jetable, stérile
Pour prélèvement cytologique endométrial. Il permet un examen facile et sans douleur de l'endomètre tout en évitant une dilatation et une traction du col de l'utérus. Une gaine extérieure recouvre un mandrin en "V" terminé par 2 branches asymétriques. Ø externe 3,0 mm - longueur 20 cm. Chaque branche possède une denture fine et de minces arêtes coupantes qui permettent d'enlever et garder plus de tissu endométrique. La tête de l'une des branches est dotée d'un bout hémisphérique qui, en rentrant à nouveau dans la gaine, permet au tissu enlevé d'être aspiré.
Commande minimum: 25 unités

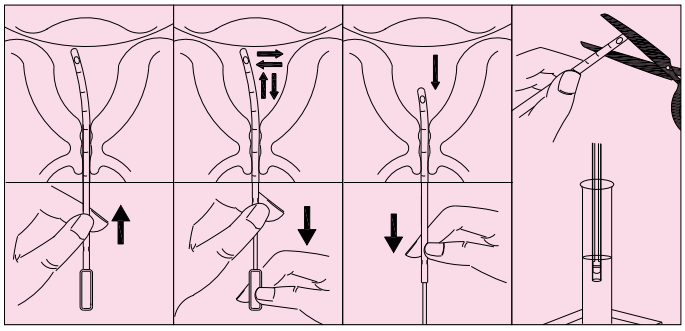

HYSTÉROMÈTRES

HYSTÉROMÈTRE à curseur - à usage unique - stérile
Graduations de lecture sur la poignée, souple.

CE 0459

Code GIMA	HYSTÉROMÈTRES USAGE UNIQUE - STÉRILE - SANS LATEX	Commande minimum
29930	Hystéromètre CH 10	25 unités
29931	Hystéromètre CH 12	25 unités
29932	Hystéromètre CH 14	25 unités

VAPORISATEUR POUR FIXATION CYTOLOGIQUE ET LAMES

29775

29777



29775



29774

Code GIMA	LAMES DE MICROSCOPE Dimensions: 76x26 mm, épaisseur 1,0 - 1,2 angles 45° commande min.: ensemble de 200 unités (4 boîtes de 50 unités)
29774	Face unie, bords rodés
29775	Une extrémité dépolie, bande sablée, bords rodés
29777	Extrémités dépolies, bande sablée, bords rodés

29776

• 29776 BOÎTE POUR LAMES
Boîte en plastique transparente pouvant contenir jusqu'à trois lames.

• 29778 VAPORISATEUR GIMAFIX POUR FIXATION CYTOLOGIQUE
Fixateur cytologique. Composition: isopropanol, polyéthylèneglycol. Ne contient pas de gaz propulseur dangereux pour la couche d'ozone.
Flacon de 250 ml.
Commande minimum: 12 flacons

29778

SPÉCULUMS VAGINAUX JETABLES STÉRILES

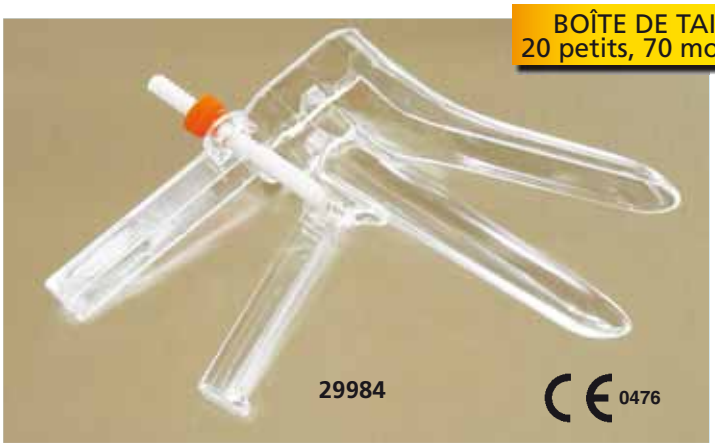

SPÉCULUM À VIS LATÉRALE, avec réglage progressif - stérile
Spéculum jetable stérile avec réglage progressif grâce à une vis. Disponible en 3 tailles. Fabriqué en Chine.

Code GIMA	SPÉCULUMS À VIS LATÉRALE - STÉRILES	Commande minimum
29983	SPÉCULUM À VIS LATÉRALE - petit Ø 20 mm	boîte de 100
29984	SPÉCULUM À VIS LATÉRALE - moyen Ø 28 mm	boîte de 100
29985	SPÉCULUM À VIS LATÉRALE - grand Ø 33 mm	boîte de 100
29986	SPÉCULUM À VIS LATÉRALE - tailles mixtes*	boîte de 100

**la boîte de tailles mixtes contient 20 petits, 70 moyens et 10 grands speculums vaginaux*

SPÉCULUM À AXE CENTRAL, VIS CENTRALE, TACHE.
3 différents modèles de spéculums stériles jetables. Vendus en boîtes de formats mixtes contenant 3 tailles: petit, moyen, grand. Fabriqué en Chine.

Code GIMA	AXE CENTRAL / VIS CENTRALE/ TACHE STÉRILE	Commande minimum
29991	SPÉCULUM À AXE CENTRAL - tailles mixtes	boîte de 100
29995	SPÉCULUM À VIS CENTRALE - tailles mixtes	boîte de 100
29987	SPÉCULUM TACHE - tailles mixtes	boîte de 100

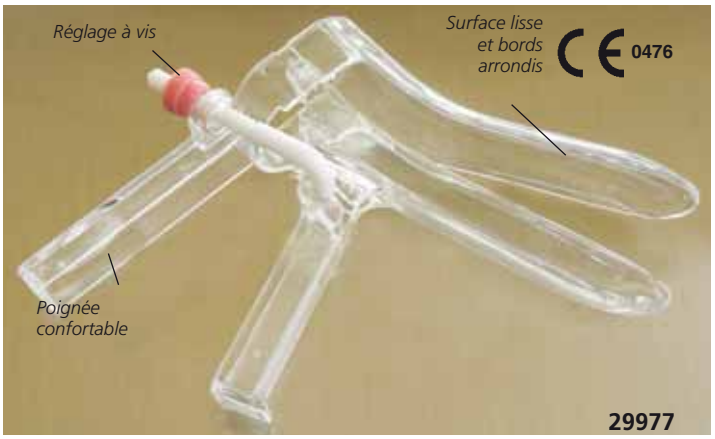

SPÉCULUM DE CUSCO - réglage progressif - stérile
Spéculum jetable avec réglage progressif par vis. Fabriqué dans une matière transparente non toxique de grande qualité, livré en emballage individuel sous vide et stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Stérilisation garantie par une étiquette spéciale de contrôle qualité apposée sur chaque emballage. Disponible en 3 tailles identifiées par différentes couleurs de vis. Fabriqué en Europe.

Code GIMA	SPÉCULUMS VAGINAUX JETABLES - STÉRILES	Commande minimum
29976	Spéculum de CUSCO - petit 85 x 20 mm	120 unités
29977	Spéculum de CUSCO - moyen 90 x 28 mm	120 unités
29978	Spéculum de CUSCO - grand 100 x 36 mm	108 unités

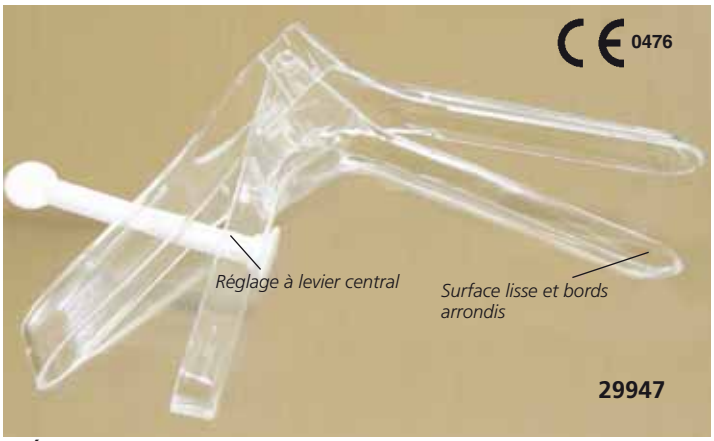

SPÉCULUM PERNO - avec levier de réglage central
Permet la dilatation du canal vaginal pour laisser apparaître le col de l'utérus. L'ouverture vaginale peut être ajustée en positionnant les valves et en verrouillant le levier central. Sa surface lisse et ses bords arrondis rendent l'introduction plus confortable. Le levier central peut être replié pour faciliter l'introduction d'instruments encombrants. 3 tailles identifiées par différentes couleurs de leviers. Fabriqué en Europe.

Code GIMA	SPÉCULUMS VAGINAUX JETABLES - STÉRILES	Commande minimum
29946	Spéculum PERNO - petit Ø 20 mm	120 unités
29947	Spéculum PERNO - moyen Ø 26 mm	120 unités
29948	Spéculum PERNO - grand Ø 30 mm	120 unités

SPÉCULUMS VAGINAUX EN ACIER INOXYDABLE - CUSCO ET COLLIN

Code GIMA	SPÉCULUMS EN ACIER INOXYDABLE
29770	Spéculum de Cusco en acier inox - petit 100 x 30 mm
29771	Spéculum de Cusco en acier inox - moyen 110 x 34 mm
29772	Spéculum de Cusco en acier inox - grand 125 x 36 mm
29773	Spéculum de Cusco en acier inox - vierge 110 x 17 mm
29763	Spéculum de Cusco en acier inox HF - moyen avec isolation pour applications HF
29768	Spéculum de Collin en acier inox - moyen

Tous les spéculums se présentent en emballage individuel dans une boîte en carton

TROUSSE POUR FROTTIS STÉRILE

CE 0373

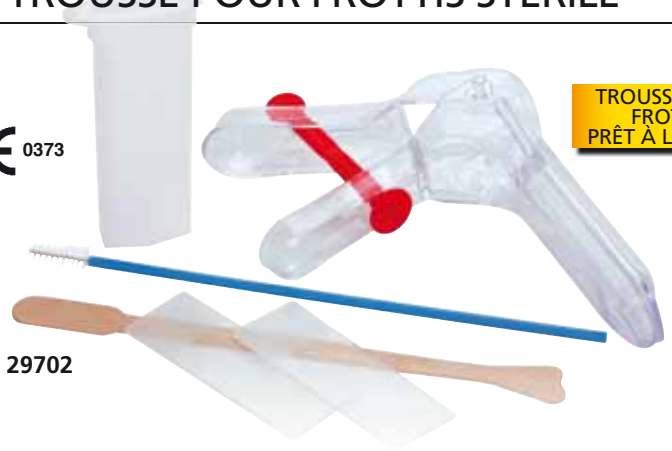

29702

TROUSSE POUR FROTTIS PRÊT À L'EMPLOI

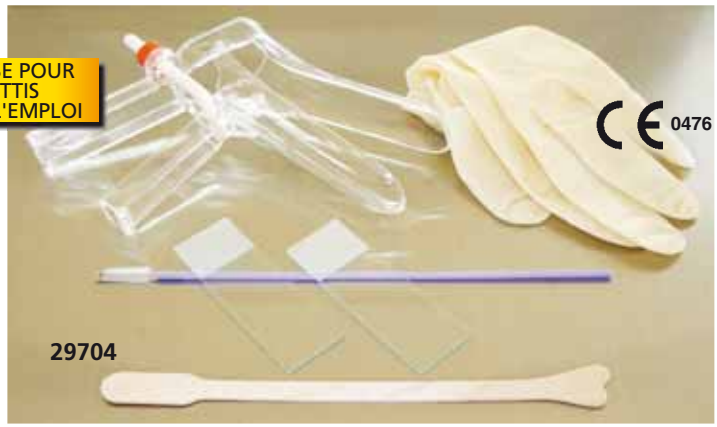

29704

CE 0476

• 29702 TROUSSE POUR FROTTIS - stérile - boîte de 100 unités.
Le frottis vaginal est un examen indolore qui détecte la présence de cellules anormales sur le col de l'utérus. Il permet un diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus.
Grâce à sa configuration fonctionnelle, le kit est prêt à l'emploi.
Il comprend: une paire de gants en latex, un spéculum à tige (taille moyenne), une brosse, une spatule d'Ayre (en bois), deux lames et une boîte pour les ranger.
Conditionnement en sachet stérile individuel.

• 29704 TROUSSE POUR FROTTIS - stérile - boîte de 50 unités
Ce kit contient: une paire de gants en latex, un spéculum à vis latérale (taille moyenne), une brosse GIMA, une spatule d'Ayre « A » (en bois), 2 lames. Emballés individuellement dans des poches stériles.

29703

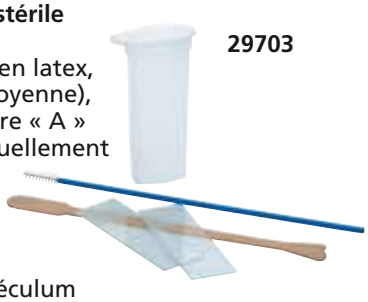

• 29703 TROUSSE POUR FROTTIS - stérile - boîte de 100 unités
Caractéristiques identiques à celles du code article 29702, mais sans spéculum

LUBRIGIMA: GEL LUBRIFIANT

• 29960 LUBRIGIMA - 250 ml
Pour faciliter l'insertion des instruments lors des examens gynécologiques.
Sa composition spéciale et sa transparence élevée n'altèrent pas le rendu visuel lorsque des instruments optiques sont utilisés. Il ne contient pas de spermicide, ne graisse pas et ne tache pas. Il présente un pH acide et une bonne conductivité électrique.
Il est hydrosoluble.
Le gel est bien absorbé par la peau et n'irrite pas les muqueuses.
Sans latex.

Commande minimum: 6 unités

29960

GEL LUBRIFIANT

• 29957 GEL LUBRIFIANT
sachet de 5 g - boîte de 100

• 29959 GEL LUBRIFIANT
tube de 82 g - 1 tube
Gel lubrifiant hypoallergénique. N'irrite pas la peau, soluble dans l'eau et facile à rincer.

29957

29959

GYNOLIGHT

29962

Livré dans une pochette souple avec deux piles 1,5 V

• 29962 GYNOLIGHT
Permet d'éclairer le canal vaginal. S'adapte aux spéculums à vis latérale ou à levier central, sans distinction.
Il est pourvu de deux sources lumineuses pour un éclairage efficace du canal vaginal, avec la possibilité pour l'utilisateur de régler l'ampoule supérieure.
Facile à poser et à retirer, grâce à son système de pattes latérales à ressort. Gynolight n'entre pas en contact avec les muqueuses.
Stérilisation à froid.

PROCTOSCOPES

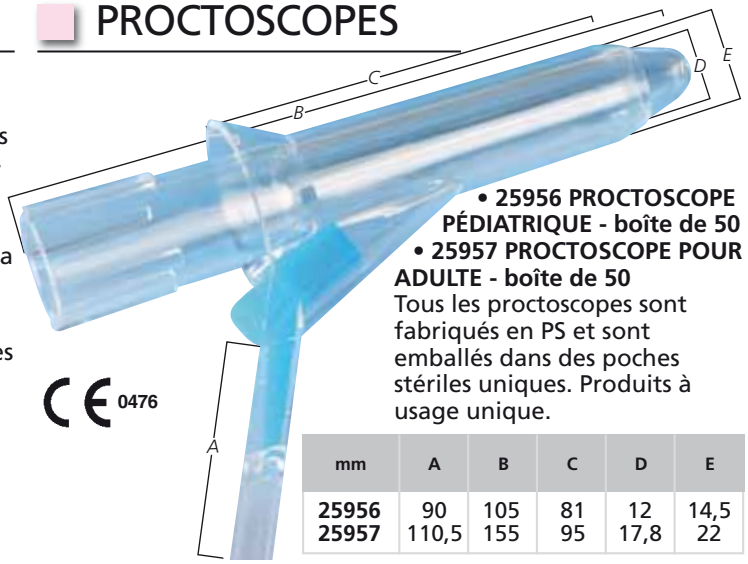

CE 0476

• 25956 PROCTOSCOPE PÉDIATRIQUE - boîte de 50
• 25957 PROCTOSCOPE POUR ADULTE - boîte de 50
Tous les proctoscopes sont fabriqués en PS et sont emballés dans des poches stériles uniques. Produits à usage unique.

mm	A	B	C	D	E
25956	90	105	81	12	14,5
25957	110,5	155	95	17,8	22